

Выбор алмазного наконечника типа НК 1 для использования в измерениях по шкале С Роквелла (при ориентации на диапазоны твёрдости изделий)

Диапазоны
твёрдости
HRC

Исходная масса алмаза наконечника НК 1 от "Восток-7"


0,2 карата
Код: 002694

0,4 карата
Код: 002695

0,6 карата
Код: 002696

0,8 карата
Код: 002697

70 —
65 —
60 —
55 —
50 —
45 —
40 —
35 —
30 —
25 —
20 —

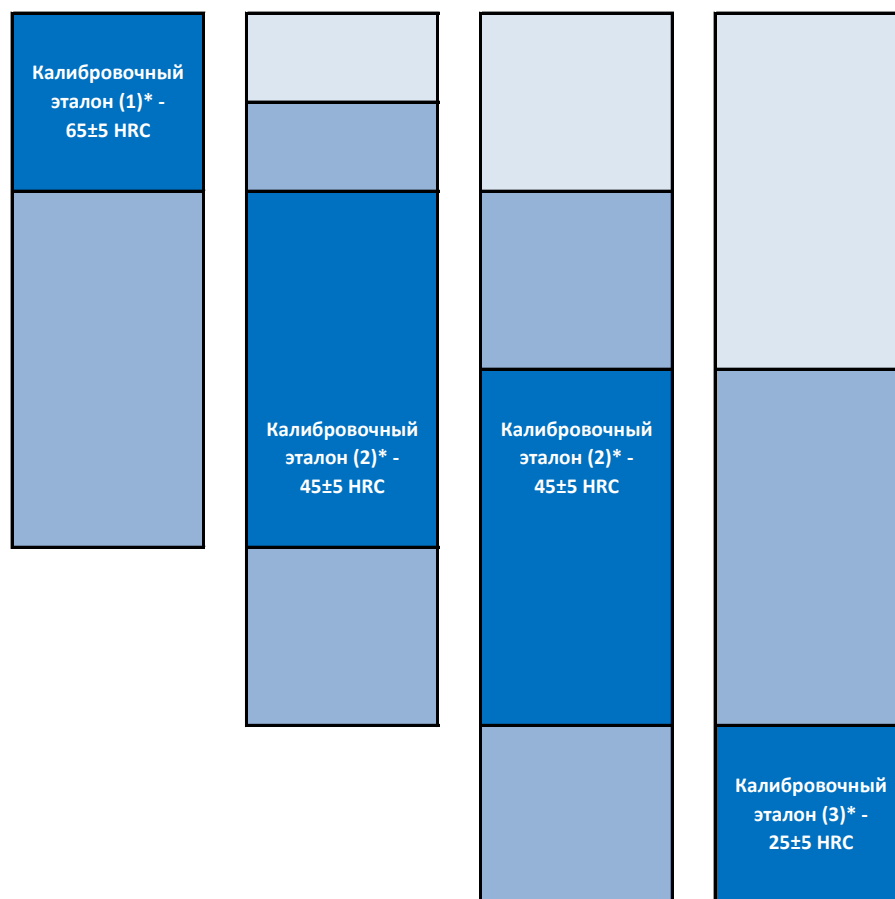

Порядок действий при выборе наконечника:

1. Если параметры наконечника указаны в производственной документации (стандартах или методике проведения измерений) - опираться на них
2. Если исходная масса алмаза явно не указана в документах, при выборе наконечника НК 1 производства "Восток-7" можно использовать данную таблицу, составленную на основе многолетнего опыта инженеров "Восток-7"



Рекомендуемый диапазон



Возможный диапазон



Допустимый диапазон

Внимание! Приведённые данные о диапазонах носят характер рекомендаций, а не обязательной информации

* **Примечание:** калибровочный эталон - рекомендуемая мера твёрдости для проверки точности показаний твердомера Роквелла перед серией измерений

(1) - 65±5 HRC - код для заказа: 002717

(2) - 45±5 HRC - код для заказа: 002716

(3) - 25±5 HRC - код для заказа: 002715

Комплект 5 мер твёрдости - код для заказа: 002633

Составители: сервисная служба компании «Восток-7», Москва, 2026